

別表3 実地監査施設のAED設置状況

施設名：奈良総合庁舎

施設の概要	
所在地	奈良市法蓮町757
AEDの調達、設置状況	
AED調達方法	リース(平成31年1月1日～令和5年12月31日)
設置台数	1台
設置場所	1階正面玄関ロビー
AED設置表示	同上
AEDの管理状況	
AED本体の耐用期間	耐用年数は超過しておらず、AED本体は特に異常無く、稼働したのを確認した。
日常点検	リース契約とは別で、保守点検契約をしている。(1年に1回の業者による点検の実施)
消耗品の管理 (電極パッド、バッテリーパックの交換時期の確認)	表示ラベルに電極パッド及びバッテリーパック交換時期等を記載しているが、バッテリーパックのみ交換時期が超過していた。
AEDの操作方法の習得	
職員向けAED操作講習の実施	特に実施していない。

AED設置状況



1階正面玄関に設置

施設名：健康・安全教育課（県立学校等所管）

施設の概要	
所在地	奈良市登大路町30番地 他42県立学校等
AEDの調達、設置状況	
AED調達方法	リース(平成30年7月1日～令和5年6月30日)
設置台数	45台(健康・安全教育課1台 他各学校に44台設置)※奈良・奈良東養護学校のみ2台設置。
設置場所	健康・安全教育課内等
AED設置表示	同上
AEDの管理状況	
AED本体の耐用期間	耐用年数は超過せず、AED本体は特に異常無く、稼働したのを確認した。
日常点検	リース契約に保守点検含まれている。(年に1回の業者バッテリーバック点検)
消耗品の管理 (電極パッド、バッテリーバックの交換時期の確認)	電極パッド及びバッテリーバック交換時期等を記載し、消耗品(電極パッド、バッテリーバック等)を適時に更新していた。 ※消耗品の管理については、健康・安全教育課管理分のみ確認。
AEDの操作方法の習得	
職員向けAED操作講習の実施	令和元年度～3年度は、コロナ禍のため、未実施。令和4年11月に各学校を対象に心肺蘇生を含むAED操作方法の講習を実施した。
その他	
本課より提供しているAED本体とは別に各学校において追加設置があれば、健康・安全教育課に報告(AED担当者も含めて)を受けている。	

AED設置状況



本庁 健康・安全教育課内に設置



AEDパッド(大人用)

施設名：中央こども家庭相談センター

施設の概要	
所在地	奈良市紀寺町833
AEDの調達、設置状況	
AED調達方法	購入（平成24年）
設置台数	1台
設置場所	1階執務室
AED設置表示	玄関前
AEDの管理状況	
AED本体の耐用期間	耐用年数は超過していたが、AED本体は特に異常無く、稼働したのを確認した。
日常点検	年に1回点検確認している。
消耗品の管理 （電極パッド、バッテリーパックの交換時期の確認）	表示ラベルに電極パッド及びバッテリーパック交換時期等を記載し、消耗品（電極パッド、バッテリーパック）を適時に更新していた。
AEDの操作方法の習得	
職員向けAED操作講習の実施	実施していない。

AED設置状況



1階執務室にて設置




AEDパッド（大人用、小児用）

施設名：奈良労働会館

施設の概要	
所在地	奈良市西木辻町93-6
AEDの調達、設置状況	
AED調達方法	購入（平成24年）
設置台数	1台
設置場所	事務室内
AED設置表示	事務室受付前
AEDの管理状況	
AED本体の耐用期間	耐用年数は超過していたが、AED本体は特に異常無く、稼働したのを確認した。
日常点検	毎月点検している。
消耗品の管理 （電極パッド、バッテリーパックの交換時期の確認）	表示ラベルに電極パッド及びバッテリーパック交換時期等を記載し、消耗品（電極パッド、バッテリーパック）を適時に更新していた。
AEDの操作方法の習得	
職員向けAED操作講習の実施	消防訓練に併せてAEDの操作にかかる講習を受講。

AED設置状況

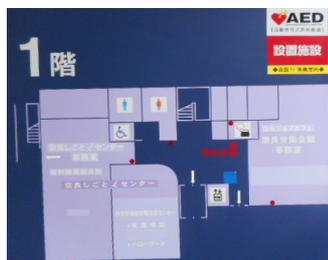

事務室受付前等にAED設置ステッカーを表示

施設名：春日野国際フォーラム（本館）

施設の概要	
所在地	奈良市春日野町101
AEDの調達、設置状況	
AED調達方法	購入
設置台数	1台
設置場所	事務室内
AED設置表示	事務室受付前
AEDの管理状況	
AED本体の耐用期間	耐用年数は超過していたが、AED本体は特に異常無く、稼働したのを確認した。
日常点検	年に2回開催の防災訓練にて確認。
消耗品の管理 (電極パッド、バッテリーパックの交換時期の確認)	電極パッドの交換時期が、超過していた。
AEDの操作方法の習得	
職員向けAED操作講習の実施	AED取扱に関する動画視聴。
その他	
令和5年度から本館は休館のため、本館にあるAEDを、別館に移動させ使用する。	

AED設置状況



事務室受付前にAED設置表示

施設名：春日野国際フォーラム（別館）

施設の概要	
所在地	奈良市雑司町469
AEDの調達、設置状況	
AED調達方法	購入
設置台数	1台
設置場所	事務室内
AED設置表示	事務室受付前
AEDの管理状況	
AED本体の耐用期間	耐用年数は超過していたが、AED本体は特に異常無く、稼働したのを確認した。
日常点検	年に2回開催の防災訓練にて確認。
消耗品の管理 (電極パッド、バッテリーパックの交換時期の確認)	電極パッドの交換時期を超過していた。
AEDの操作方法の習得	
職員向けAED操作講習の実施	AED取扱に関する動画視聴。
その他	
令和5年度から本館は休館のため、本館にあるAEDを、別館に移動させ使用する。	

AED設置状況



事務室受付前にAED設置表示




AED点検手順書及び使用手順書

施設名：中央卸売市場

施設の概要	
所在地	大和郡山市筒井町957番地の1
AEDの調達、設置状況	
AED調達方法	購入
設置台数	1台
設置場所	守衛所北側内
AED設置表示	管理棟玄関入り口等
AEDの管理状況	
AED本体の耐用期間	耐用年数は超過していたが、AED本体は特に異常無く、稼働したのを確認した。
日常点検	書面監査以降、日常点検を実施していた。
消耗品の管理 (電極パッド、バッテリーパックの交換時期の確認)	表示ラベルに電極パッド及びバッテリーパック交換時期等を記載し、消耗品(電極パッド、バッテリーパック等)を適時に更新していた。
AEDの操作方法の習得	
職員向けAED操作講習の実施	特に実施していなかった。
その他	
年度内にAED2台購入予定である。	

AED設置状況

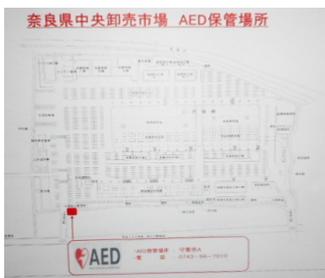

AED日常点検チェックリスト (ハートスターHS1/HS1e)	
点検日	点検者
1. 0. 20	1. 18
2. 0. 15	2. 17
3. 0. 12	3. 16
4. 0. 10	4. 15
5. 0. 20	5. 20
6. 0. 21	6. 21
7. 0. 22	7. 22
8. 0. 23	8. 23
9. 0. 24	9. 24
10. 0. 25	10. 25
11. 0. 26	11. 26
12. 0. 27	12. 27
13. 0. 28	13. 28
14. 0. 29	14. 29
15. 0. 30	15. 30
16. 0. 31	16. 31

管理棟 玄関入り口等にAED保管場所