

## XI 水質検査体制

### 水質担当職員一覧

平成29年4月3日現在

#### 水道局業務課

〒630-8113 奈良市法蓮町757 TEL 0742-20-4624 FAX 0742-22-2420

事業管理係

主 査 山 口 洋 徳 (化学)

#### 広域水道センター

〒639-1041 大和郡山市満願寺町444-3 TEL 0743-54-5985 FAX 0743-58-2515

広域水道課

広域水道係

主 事 下 田 明 史 (化学)

#### 水質管理センター

〒633-0112 桜井市初瀬3701 TEL 0744-47-8295 FAX 0744-44-3003

所 長 松 本 英 俊 (化学)

水質課

課 長 沼 田 孝 (化学)

企画調整係

係 長 桐 山 秀 樹 (化学)

主 査 前 田 年 宏 (化学)

主任主事 倉 田 彰 弘 (化学)

主 事 菊 池 満 (化学)

桜井水質係

係 長 田 村 道 也 (生物)

主 事 上 田 薫 (化学)

#### 御所浄水場内

〒639-2251 御所市戸毛367-2 TEL 0745-67-1081 FAX 0745-67-9014

企画調整係

主 事 浅 野 雄 三 (化学)



御所水質係

係 長 山 本 徹 (化学)


主 査 藤 岡 靖 弘 (化学)

# 水質試験室配置図

## 1. 桜井浄水場

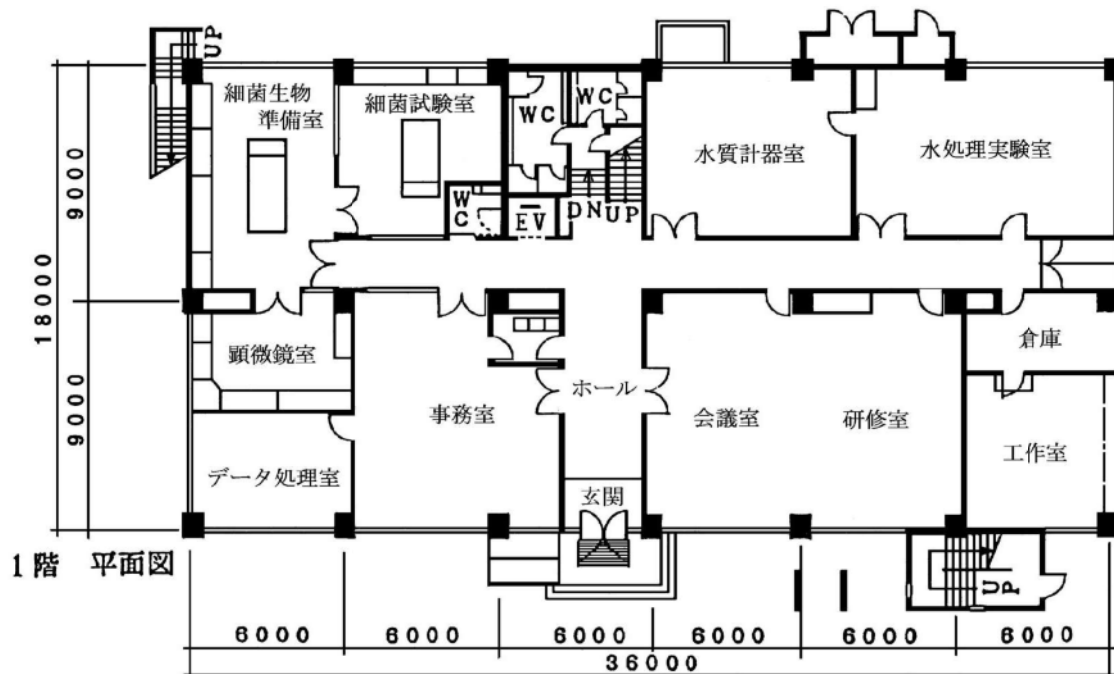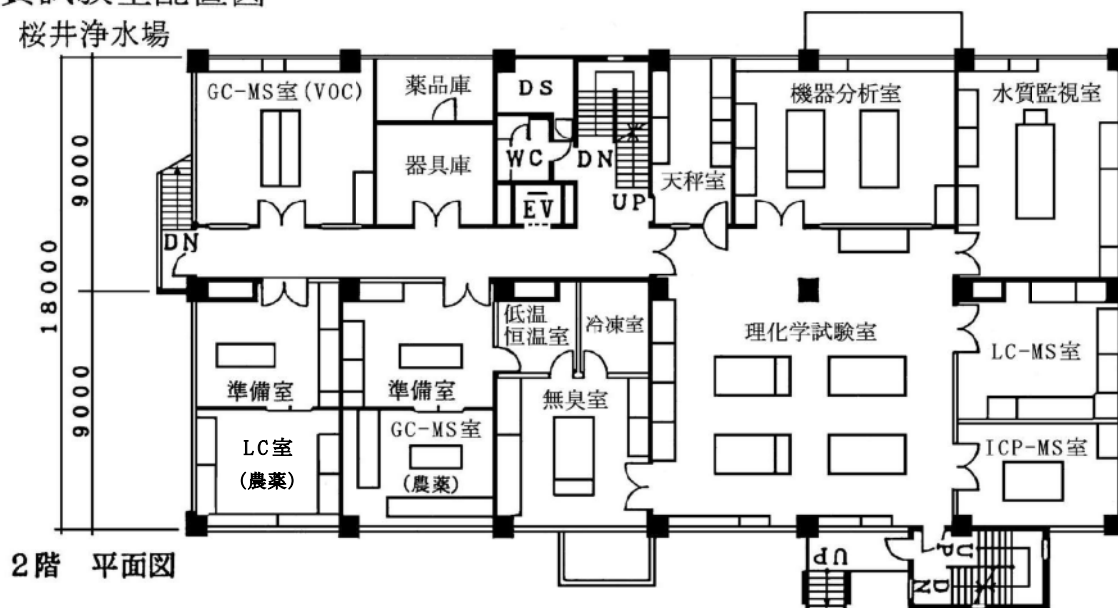

## 2. 御所浄水場

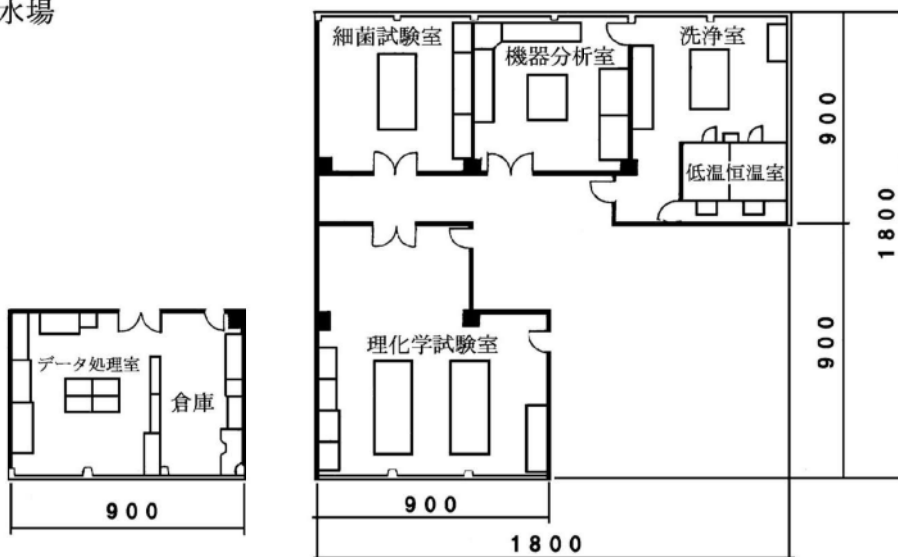

## 〈お知らせ〉水道GLPの認定取得について

平成19年10月30日、奈良県水道局は水道GLP(水道水質検査優良試験所規範)の認定を取得し、平成27年10月30日に認定を更新しました。

水道GLPの認定取得により、奈良県水道局の水道水質検査の信頼性と技術力が高く評価され、水道水の安全性が保証されたものと考えています。

今後とも、県民の皆様の水道水質への期待に応えていくよう、より安全でおいしい水づくりに取り組んでまいります。


### 水道GLP認定取得の概要

- 目的：水道水質検査の精度と信頼性を確保すること
- 認定日：平成27年10月30日(初回認定日:平成19年10月30日)
- 認定機関：(公社)日本水道協会 水道GLP認定委員会
- 認定対象部署：奈良県広域水道センター水質管理センター
- 認定範囲：水道水質基準項目 水道水・浄水(51項目)

〈認定マーク〉



**JWWA-GLP029**  
水道GLP認定

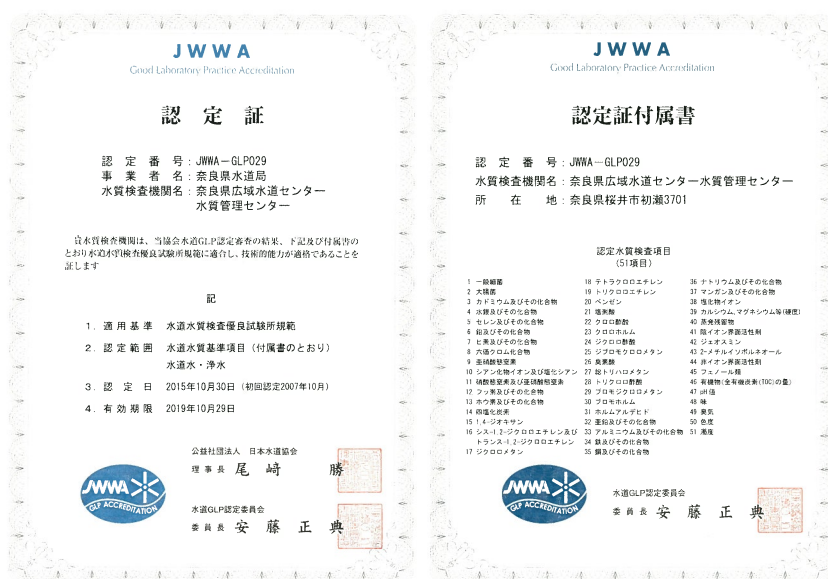

〈認定証・同付属書〉

### ※水道GLPとは？

- ▶水道水質検査の精度と信頼性を確保するための認定基準。
- ▶国際規格である ISO9001 及び ISO/IEC17025 の要求事項を基に、水道水質検査に特化して(公社)日本水道協会が策定したもので、審査・認定・登録も同協会が実施。
- ▶管理組織・検査手順・試薬管理・検査機器の保守管理等について全て文書化され、それらが要求事項に適合しているかを審査。また、検査技術を確認する技術審査も実施。